

**CDI dental AB**  
 Höjdrodergatan 18, 212 39 Malmö, Sweden  
 Tel 040-607 77 70, Fax 040-607 77 80  
 E-mail: info@cdi-dental.com, www.cdi-dental.com  
 Org.nr: 556673-0890



CDI Reg.datum

Tandläkare/Klinik/Adress/Tel

Beställningsdatum

Ordernummer

Kundnummer

Välj typ av prislista

SQ

Loyalty Member

Patientnamn

Personnummer

-

Markera typ av arbete	Mk CoCr <input type="checkbox"/>	Mk Guld <input type="checkbox"/>	Pelare CoCr <input type="checkbox"/>	Pelare Guld <input type="checkbox"/>	Fullkrona <input type="checkbox"/>	Inlägg <input type="checkbox"/>	Komb arbete <input type="checkbox"/>	Maryland bro <input type="checkbox"/>	Helkeramik		
	KBF Gjutén <input type="checkbox"/>	Mk Titan <input type="checkbox"/>	Titan <input type="checkbox"/>	CDI Zirconia (Full Zirconia) <input type="checkbox"/>	Zirconia <input type="checkbox"/>	E-max <input type="checkbox"/>	Rochette <input type="checkbox"/>				
	KBF Fräst <input type="checkbox"/>	KBF Skruv <input type="checkbox"/>	Komposit <input type="checkbox"/>	Protes <input type="checkbox"/>	Partial protes <input type="checkbox"/>	Skelett <input type="checkbox"/>	Bettskena <input type="checkbox"/>	Lagning <input type="checkbox"/>	Provningsdatum		
	KBF Cem <input type="checkbox"/>	Akryl <input type="checkbox"/>	Flexprotes <input type="checkbox"/>	Temporär <input type="checkbox"/>	Ortodonti <input type="checkbox"/>						


Implantat System:

Anvisning

Fullt färdig

Färg

Färganvisning



Mindre>ytstruktur<mycket

Mellanrumsborste för spolrum


Mattare>ytglans<glansigare

Röd  Blå


Ingen>infärgning<mycket

Gul  Grön

Lila  Grå

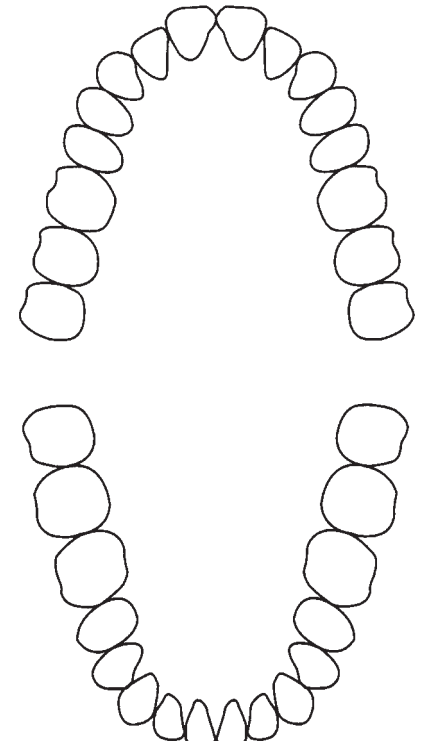

Utformning av pontic

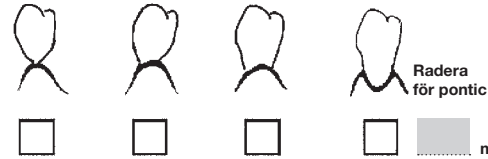

Radera för pontic

mm

Utformning av synlig metal, Cervical kant, Occlusalt, Lingualt

- Cervikal metallkant
- Lingual cervical metallkant
- Ingen synlig metall
- Lingual och ocklusalyta i metall exkluderat buckal kusp
- Lingual och ocklusalyta i metall inkluderat buckal kusp

Typ av Ocklusionskontakt

- Hård
- Svag
- Ingen

Information från laboratoriet

Desinficerat la

Desinficerat td

Kvalitetskontroll Lab Sign.



TDL Sign\*



\*Lagkrav enligt Läkemedelsverket

CDI försäkrar att produkten uppfyller de tillämpliga kraven i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter samt, samt de väsentliga kraven i bilaga 1 och 6 i läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11)



**CDI dental AB**  
 Höjrodergatan 18, 212 39 Malmö, Sweden  
 Tel 040-607 77 70, Fax 040-607 77 80  
 E-mail: info@cdi-dental.com, www.cdi-dental.com  
 Org.nr: 556673-0890



CDI Reg.datum

Tandläkare/Klinik/Adress/Tel

Beställningsdatum

Ordernummer

Kundnummer

Välj typ av prislista

SQ

Loyalty Member

Patientnamn

Personnummer

-

Markera typ av arbete	Mk CoCr <input type="checkbox"/>	Mk Guld <input type="checkbox"/>	Pelare CoCr <input type="checkbox"/>	Pelare Guld <input type="checkbox"/>	Fullkrona <input type="checkbox"/>	Inlägg <input type="checkbox"/>	Komb arbete <input type="checkbox"/>	Maryland bro <input type="checkbox"/>	Helkeramik		
	KBF Gjutén <input type="checkbox"/>	Mk Titan <input type="checkbox"/>	Titan <input type="checkbox"/>	Titan <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rochette <input type="checkbox"/>	CDI Zirconia (Full Zirconia) <input type="checkbox"/>	Zirconia <input type="checkbox"/>	E-max <input type="checkbox"/>
	KBF Fräst <input type="checkbox"/>	KBF Skruv <input type="checkbox"/>	Komposit <input type="checkbox"/>	Protes <input type="checkbox"/>	Partial protes <input type="checkbox"/>	Skelett <input type="checkbox"/>	Bettskena <input type="checkbox"/>	Lagning <input type="checkbox"/>	Provningsdatum		
	KBF Cem <input type="checkbox"/>	Akryl <input type="checkbox"/>	Flexprotes <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Temporär <input type="checkbox"/>	Ortodonti <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			


Implantat System:

Anvisning

Fullt färdig

Färg

Färganvisning



Mindre>ytstruktur<mycket

Mellanrumsborste för spolrum

Mattare>ytglans<glansigare


Röd  Blå

Ingen>infärgning<mycket

Gul  Grön

Lila  Grå

Utformning av pontic

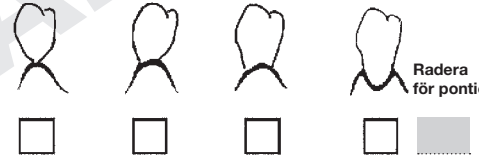


Radera för pontic

Utformning av synlig metal, Cervical kant, Occlusalt, Lingualt

- Cervikal metallkant
- Lingual cervical metallkant
- Ingen synlig metall
- Lingual och ocklusalyta i metall exkluderat buccal kusp
- Lingual och ocklusalyta i metall inkluderat buccal kusp

Typ av Ocklusionskontakt

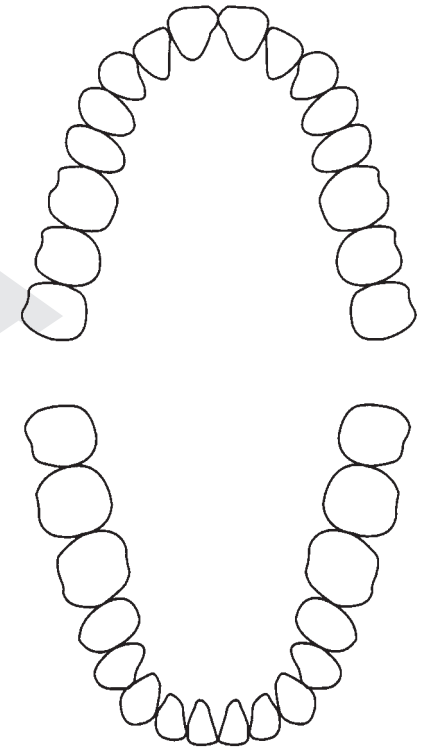

Information från laboratoriet

Desinficerat la

Desinficerat td

Kvalitetskontroll Lab Sign.



TDL Sign\*



\*Lagkrav enligt Läkemedelsverket

CDI försäkrar att produkten uppfyller de tillämpliga kraven i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter samt, samt de väsentliga kraven i bilaga 1 och 6 i läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11)

